關於替換用膠捲

●要更換膠捲時，請使用「專利除臭抗菌尿布處理器」的專用替換用膠捲（另購）。

⚠注意

• 請務必使用「專利除抗菌尿布處理器」的專用膠捲。

使用於寵物用品時


• 附著於紙尿布或座墊上的寵物糞便，請先去除至馬桶後，並且將尿布的體積縮緊後再丟入尿布處理器內。
• 請勿將紙尿布或座墊塞入過滿的處理器內。（當處理器接近滿的狀態下，請立即將處理器內的紙尿布取出。）

〈收容量的參考值〉

標準尺寸(約44cm x 32cm左右)
約可裝入 **24** 片左右

大型尺寸(約90cm x 60cm左右)
約可裝入 **5** 片左右

• 當座墊髒污時，請將髒汙那面保持於內側捲起。
• 當大型寵物座墊髒污時，折疊方法請參考右圖。

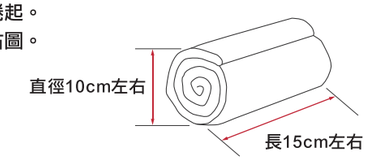

清洗方法

• 髒污時，請使用中性洗潔劑溶解於溫水中，並且用抹布沾濕後擦拭即可。

廢棄方法

• 為維護地球環境，請勿隨意放置丟棄。
• 請依照各區域的廢棄物處理方法來處理。

⚠注意

• 請勿使用有機溶劑（揮發油等）類清潔用品來清潔本產品。因恐造成樹脂材料損壞或變形。
• 請勿使用水清洗本產品。金屬零件恐有生鏽之虞。

Japan
アップリカ·チルドレンズプロダクツ合同会社
本社/大阪店 —〒542-0082大阪市中央区島之内1-13-13 **TEL** 0120-415-814

Taiwan
台灣愛普力卡股份有限公司
302 新竹縣竹北市台元街28號5樓之3 http://www.aprica.com.tw 製造產地：中國
TEL：(03) 552-5688 意見信箱：0800@aprica.com.tw 統一編號：22662003

〈麻煩您〉
• 若本說明書有錯誤或記載漏失的地方，請利用上方的聯絡資訊與我們連絡。
• 為不斷追求品質經進，請見諒產品上的設計、顏色、形狀等無預告的變更。

Aprica


紙おむつ処理ポット

におわなくてポイ

消臭タイプ

專利除臭抗菌尿布處理器

使用說明書

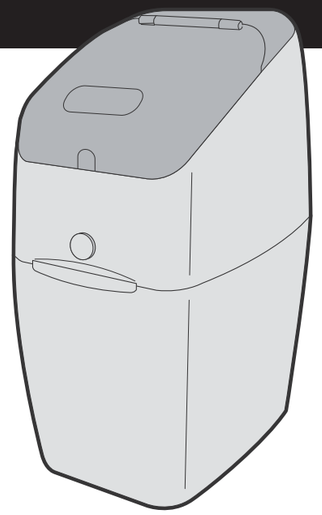

本產品可使用於以下的用途。
• 處理嬰幼兒至成人使用之紙尿布。
• 處理女性的生理用品。
• 處理寵物用紙尿布或丟棄式座墊等。

感謝您正確的選擇了從嬰兒醫學中誕生的愛普力卡產品。使用之前，請仔細閱讀本說明書後再開始使用。請勿進行說明書以外的使用方法，以避免無法預期的危險。閱讀後，請務必妥善保管本說明書。

⚠警告 使用方法錯誤時，可能會造成使用者死亡或重傷的情形。


• 本產品的包裝袋或包裝材請於拆裝後放置於嬰幼兒拿不到之處。因恐放進口中，而衍出誤食或窒息的狀況。
• 請勿將本產品上蓋與主體分離。因恐嬰幼兒不慎碰觸切斷器（切斷膠捲用）而造成受傷的情形發生。
• 請務必謹慎地安裝金屬棒。因恐尖端處會造成使用者受傷的情形發生。
• 組裝請由監護人來進行。因恐組裝不當而造成嬰幼兒受傷的事故發生。
• 請特別注意絕對禁止以下的使用方式。因恐使用不當而造成嬰幼兒受傷的事故發生。
  ・使用已經破損或變形的製品。
  ・嬰幼兒沒有在監護人的看管下，將本產品當作墊腳物或椅子使用。
  ・當成嬰幼兒的玩具使用。
  ・將本產品用於尿布處理器以外的任何目的使用。

⚠注意 使用方法錯誤時，可能會造成人員的受傷、物體的故障、異常等原因發生，請務必遵守。


• 請勿置於日光直射處或靠近火源處。容易造成樹脂材料變形而無法維持其原有功能之可能性。
• 請勿使用有機溶劑（揮發油等）類清潔用品來清潔本產品。因恐造成樹脂材料損壞或變形。
• 請避免使本產品掉落等強烈撞擊。因恐有造成破損之虞。
• 請勿使用水清洗本產品。金屬零件恐有生鏽之虞。
• 請務必使用「專利除抗菌尿布處理器」的專用膠捲。

從盒中取出本產品時

- 本產品的尿布處理器主體和主體上蓋是重疊並且捆包在一起。
- 製品取出時，請務必確認部品是否齊全或是否有破損的情形。

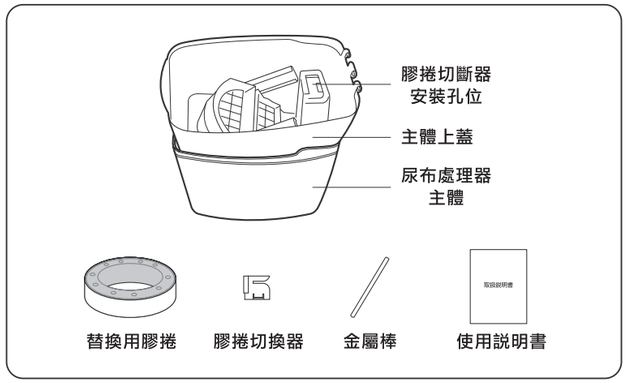


〈各部位名稱〉

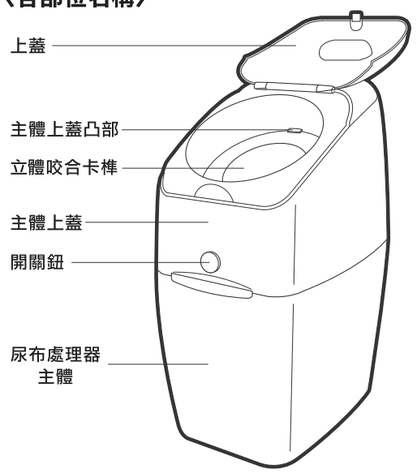


產品組裝方法


⚠警告
- 本產品的包裝袋或包裝材請於拆裝後放置於嬰幼兒拿不到之處。因恐放進口中，而衍出誤食或窒息的狀況。

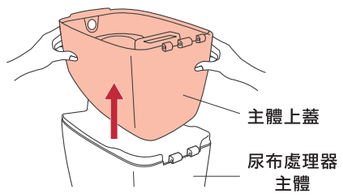

❶將主體上蓋與尿布處理器主體分開。




❷將放置於尿布處理器主體內的包裝材、替換用膠捲、膠捲切斷器以及金屬棒等取出。

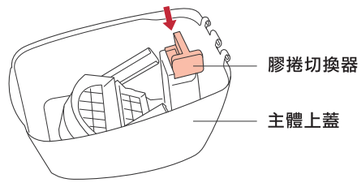


❸將膠捲切斷器安裝於主體上蓋內的膠捲安裝孔位，聽到”嘎磕”聲才表示完成安裝。

❹請務必確認膠捲切斷器為無法被抽出的狀態。

⚠警告
- 請勿將本產品上蓋與主體分離。因恐嬰幼兒不慎碰觸切斷器（切斷膠捲用）而造成受傷的情形發生。

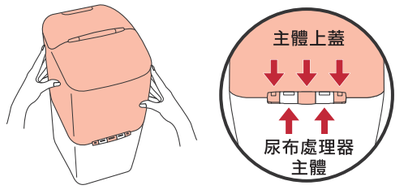

❺將主體上蓋與尿布處理器主體組合起來。

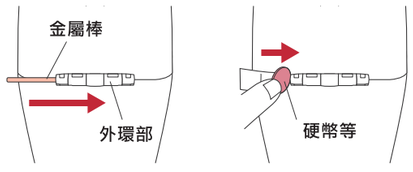

❻ 請將金屬棒插入外環部，再以硬幣等將金屬棒壓到底即可。

⚠警告
- 請務必謹慎地安裝金屬棒。因恐尖端處會造成使用者受傷的情形發生。
- 組裝請由監護人來進行。因恐組裝不當而造成嬰幼兒受傷的事故發生。


替換用膠捲使用方法




❶將替換用膠捲的包材卸除。




❷將膠捲的上端部位拉出5cm。

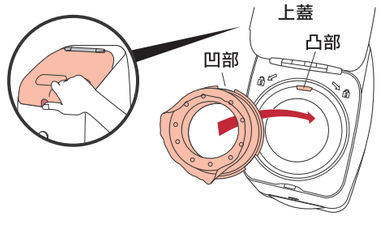


❸打蓋上蓋，將膠捲盒的凹部和主體上蓋的凸部嵌合為一體即可。



❹將膠捲盒往右旋轉，使膠捲盒與主體自動崁合。




❺將膠捲抽出約40cm，並且在前端打結。




❻將打結完成後的膠捲前端全部壓進主體內部。

使用過後的紙尿布丟棄方式


- 附著於尿布上的糞便，請先去除至馬桶後，並且將尿布的體積縮緊後再丟入尿布處理器內。



❶將上蓋打開，並且將紙尿布放入。



❷向下壓至立體咬合卡榫，使紙尿布掉入尿布處理器內。




❸確認立體咬合卡榫關閉後，闔上上蓋即可。

※將紙尿布壓入主體內部（立體咬合卡榫內部），如果有推不進去的狀態，表示處理器內的紙尿布已滿。


〈收容量的參考值〉 嬰兒用紙尿布　新生兒用約３０片左右　S~L尺寸約２４片左右　L尺寸以上約２０片左右
大人用紙尿布　全開式約３片左右　內褲式紙尿布約２０片左右

紙尿布的取出方法


⚠警告
- 請勿將本產品上蓋與主體分離。因恐嬰幼兒不慎碰觸切斷器（切斷膠捲用）而造成受傷的情形發生。




❶按下開關鈕，打開主體上蓋。

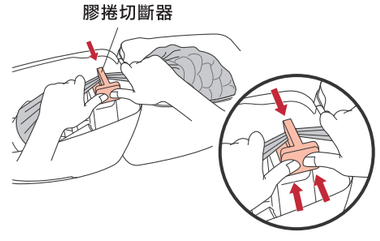

❷如上圖所示，兩手握住兩側膠捲，並且使用拇指的力量推動切斷器切斷膠捲。
※切斷膠捲時，請稍微晃動。




❸將切斷的膠捲處打結並取出。




❹將剩餘的膠捲抽出約40cm並且於前端打結。闔上本體上蓋即可。

〈建議〉


膠捲切斷前，儘可能將廢棄物壓縮集中，以節省膠捲的使用量。



替換用膠捲的取出方法



❶替換用膠捲向左旋轉以解除鎖定。



❷取出替換用膠捲。